



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.34.004.А № 78187

Срок действия до 01 сентября 2025 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ
Барьеры искрозащиты ЭНИ-БИС-Ex (Метран-630-Ex)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ
Общество с ограниченной ответственностью "Энергия-Источник"
(ООО "Энергия-Источник"), г. Челябинск

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 79110-20

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ
ЭИ.85.00.000МИ

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Тип средств измерений утвержден приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 01 сентября 2020 г. № 1458

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства

А.В.Кулешов



"04" 09

2020 г.

Серия СИ

№ 046057

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Барьеры искрозащиты ЭнИ-БИС-Ex (Метран-630-Ex)

Назначение средства измерений

Барьеры искрозащиты ЭнИ-БИС-Ex (Метран-630-Ex) (далее барьеры) предназначены для преобразования аналоговых сигналов силы и напряжения постоянного тока, электрического сопротивления от датчиков, источников питания и других технических средств контроля и автоматики, расположенных во взрывоопасной зоне, в аналоговые сигналы силы постоянного тока, в сигналы реле, передачи этих сигналов во взрывобезопасную зону, а также для питания пассивных датчиков, расположенных во взрывоопасной зоне.

Описание средства измерений

Принцип действия барьеров состоит в измерительном преобразовании аналоговых сигналов датчиков или других измерительных устройств, расположенных во взрывоопасной зоне, в аналоговый сигнал силы постоянного тока во взрывобезопасную зону. В качестве разделительного элемента между искробезопасными и искроопасными цепями служит встроенный блок искрозащиты, состоящий из шунтирующих стабилитронов, последовательно включенных резисторов и предохранителей, имеющий гальваническую связь с цепью заземления. Для повышения надежности барьеров цепочка шунтирующих стабилитронов продублирована (троирована — для ЭнИ-БИС-300-Ex). Стабилитроны, диоды и резисторы служат для ограничения напряжения и тока на искробезопасном входе до безопасных уровней в аварийных ситуациях. Диодно-резистивные или резистивные цепи с плавкими предохранителями служат для отключения искробезопасной цепи при возникновении аварийных напряжений на искроопасном выходе. Резистор в этих цепях обеспечивает ограничение величины тока, протекающего через предохранитель, при случайном попадании на барьер напряжения величиной до 250 В. Этим исключается дуговой эффект в слаботочном плавком предохранителе.

В зависимости от назначения и принципа действия барьеры выпускаются в следующих сериях: ЭнИ-БИС-2xx-Ex, ЭнИ-БИС-3xx-Ex.

Барьеры серии ЭнИ-БИС-2xx-Ex являются активными.

Барьеры серии ЭнИ-БИС-3xx-Ex являются активными и имеют гальваническую развязку между входом, выходом и источником питания.

В зависимости от технических и метрологических характеристик барьеры могут иметь различные конструктивные исполнения и комплектность. Обозначение исполнения барьеров в зависимости от заказа приведено в виде буквенно-цифрового кода в эксплуатационном паспорте. Буквенно-цифровой код может в себя включать следующую информацию: наименование серии с индивидуальным номером, обозначение искробезопасного оборудования (Ex), тип передаваемого сигнала, количество каналов, тип входного/выходного сигнала, наличие дополнительной технологической наработки, наличие поверки. Например, барьер искрозащиты с гальванической развязкой серии 300 исполнения 301, с аналоговым входным сигналом, одноканальный, с выходным сигналом 0-20 мА, технологической наработкой 360 ч имеет следующее обозначение: ЭнИ-БИС-301-Ex-AI-1к-020-360.

Защита барьера от несанкционированного вскрытия обеспечивается нанесением пломбы / гарантийной этикетки (одной или нескольких в зависимости от конструктивного исполнения) на корпус барьера. Пломба (гарантийная этикетка) представляет собой саморазрушающуюся наклейку, которая наносится в месте соприкосновения основания и крышки корпуса барьера.

Внешний вид барьеров представлен на рисунках 1—2.

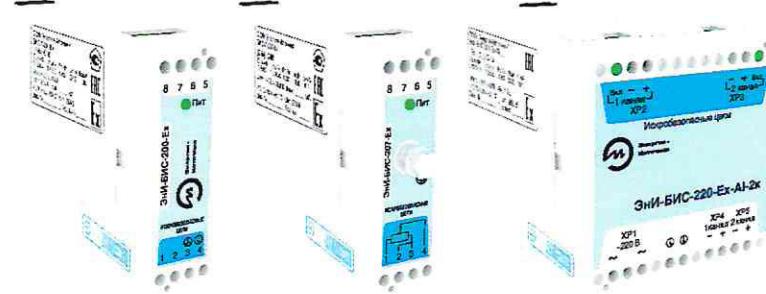


Рисунок 1 — Внешний вид барьеров серии ЭНИ-БИС-2xx-Ex

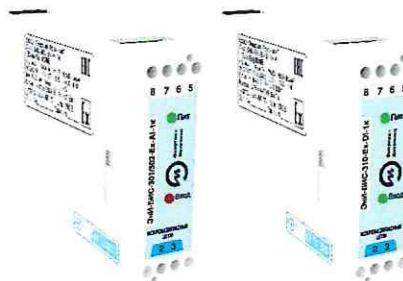


Рисунок 2 — Внешний вид барьеров серии ЭНИ-БИС-3xx-Ex

Барьеры могут применяться в различных отраслях промышленности в системах автоматического контроля, регулирования и управления технологическими процессами, связанными с получением, переработкой, использованием и хранением взрывоопасных и пожароопасных веществ.

Барьеры выполнены в соответствии с требованиями, предъявляемыми к взрывозащищенному электрооборудованию подгруппы IIС, IIВ и поэтому их область применения охватывает все производства и технологические процессы (с зонами или помещениями), в которых имеются или могут образовываться различные взрывоопасные смеси газов, пары нефтепродуктов.

Программное обеспечение
отсутствует.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические характеристики барьеров приведены в таблице 1.

Технические характеристики барьеров приведены в таблице 2.

Таблица 1 — Метрологические характеристики барьеров

Наименование характеристики	Значение
Диапазон входного сигнала ¹⁾	от 4 до 20 мА от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 0 до 5 В
Диапазон выходного сигнала ¹⁾	от 0 до 5 мА от 0 до 20 мА от 4 до 20 мА
Пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования сигналов, % от диапазона изменения выходного сигнала	$\pm 0,1^2)$; $\pm 0,2^2)$
Пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности преобразования от изменения температуры окружающего воздуха в рабочем диапазоне температур, % от диапазона изменения выходного сигнала на каждые 10 °C	$\pm 0,1$; $\pm 0,2^3)$
Пределы допускаемой дополнительной приведённой погрешности преобразования от изменения напряжения питания, %	$\pm 0,1$
Нормальные условия: - температуры окружающей среды, °C - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от +21 до +25 от 30 до 80 от 84,0 до 106,7
Примечание.	
¹⁾ Диапазон входного/выходного сигналов зависит от модификации барьера и выбирается потребителем при заказе.	
²⁾ Значения пределов допускаемой основной приведённой погрешности преобразования зависят от модификации барьера и выбираются потребителем при заказе, кроме ЭнИ-БИС-301-Ex-AI-1к, ЭнИ-БИС-302-Ex-AI-1к, ЭнИ-БИС-320-Ex-AI-1к-Н для выходного сигнала от 0 до 5 мА, для которых пределы допускаемой основной приведённой погрешности преобразования $\pm 0,2\%$.	
³⁾ Только для ЭнИ-БИС-203-Ex, ЭнИ-БИС-204-Ex.	

Таблица 2 — Основные технические характеристики

Наименование характеристики	Значение
Параметры электрического питания (в зависимости от модификации): - напряжение постоянного тока, В - напряжение постоянного тока, В - напряжение питания переменного тока, В - частота переменного тока, Гц	36±3,6 24±0,5 (2,4) от 187 до 242 от 49 до 51
Потребляемая мощность (в зависимости от модификации): - с напряжением питания постоянного тока, Вт, не более - с напряжением питания переменного тока, В·А, не более	3,5 6
Масса, кг, не более серия ЭнИ-БИС-2xx-Ex серия ЭнИ-БИС-3xx-Ex	0,5 0,1
Габаритные размеры (высота, ширина, длина), мм, не более серия ЭнИ-БИС-2xx-Ex серия ЭнИ-БИС-3xx-Ex	125x77x70 110x76x23
Рабочие условия: - температура окружающей среды, °C - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа	от -10 до +50 от 30 до 80 от 84,0 до 106,7
Средний срок службы, лет, не менее	12

Знак утверждения типа

наносится на боковую или лицевую (в зависимости от конструктивного исполнения) сторону барьера способом, обеспечивающим долговечность маркировки, и/или на титульный лист паспорта и руководства по эксплуатации типографским способом.

Комплектность средства измерений

Таблица 3 — Комплектность барьеров ЭнИ-БИС-2xx-Ex

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Барьер ЭнИ-БИС-2xx-Ex	—	1	соответственно заказу
Паспорт	ЭИ.85.00.000ПС	1	
Руководство по эксплуатации	ЭИ.85.00.000-ххРЭ		допускается поставлять по 1 шт. на 30 барьеров, поставляемых в один адрес
Методика поверки	ЭИ.85.00.000МИ		
DIN-рейка	NS35\7,5		по заказу

Таблица 4 — Комплектность барьеров ЭнИ-БИС-3xx-Ex

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Барьер ЭнИ-БИС-3xx-Ex	—	1	соответственно заказу
Паспорт	ЭИ.85.00.000ПС	1	
Руководство по эксплуатации	ЭИ.173.00.000-ххРЭ		допускается поставлять по 1 шт. на 30 барьеров, поставляемых в один адрес
Методика поверки	ЭИ.85.00.000МИ		
Модуль резисторов NAMUR ЭнИ-410	ЭИ.232.00.000		по заказу
DIN-рейка	NS35\7,5		по заказу

Проверка

осуществляется по документу ЭИ.85.00.000МИ «Барьеры искрозащиты ЭнИ-БИС-Ex (Метран-630-Ex). Методика поверки», утвержденному ФГУП «ВНИИМС» 25.11.2019 г.

Основные средства поверки:

калибратор многофункциональный и коммуникатор BEAMEX MC6 (-R), регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 52489-13;

мультиметр цифровой прецизионный Fluke 8508A, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 25984-14;

мера электрического сопротивления Р331;

магазин сопротивления измерительный MCP-60M, регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 2751-71.

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик, поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в соответствующий раздел паспорта на барьер или на свидетельство о поверке.

Сведения о методиках (методах) измерений.

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к барьерам искрозащиты ЭнИ-БИС-Ex (Метран-630-Ex)

ГОСТ 52931-2008 Приборы контроля и регулирования технологических процессов. Общие технические условия

ГОСТ 31610.0-2014 (IEC 60079-0:2011) Взрывоопасные среды. Часть 0. Оборудование. Общие требования

ТУ 4218-007-51465965-2004 Барьеры искрозащиты ЭнИ-БИС-Ex (Метран-630-Ex). Технические условия

Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «Энергия-Источник»
(ООО «Энергия-Источник»)

Адрес: 454138, г. Челябинск, пр. Победы, д. 290, оф. 112

Телефон: +7 (351) 749-93-60

Web-сайт: <http://www.eni-bbmv.ru>

E-mail: info@en-i.ru

Испытательный центр

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский научно-исследовательский институт метрологической службы» (ФГУП «ВНИИМС»)

Адрес: 119361, г. Москва, ул. Озерная, д.46


Телефон: +7 (495) 437-55-77

Web-сайт: www.vniims.ru

E-mail: office@vniims.ru

Аттестат аккредитации ФГУП «ВНИИМС» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30004-13 от 29.03.2018 г.

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии

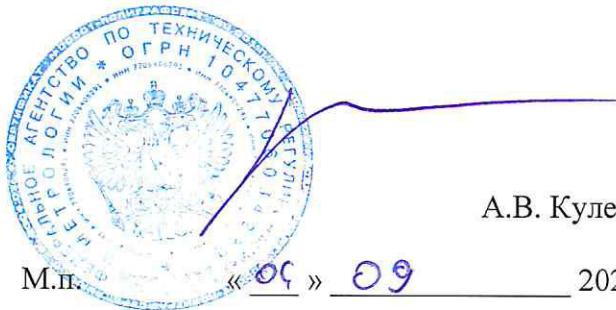

А.В. Кулешов

М.п. « 05 » 09 2020 г.